

wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 25.11.2020
EZ/350/72/2020/... 800.....

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 72/2020

dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielmy odpowiedzi:

PYTANIE

Pakiet 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1. Serweta o wymiarach 180 cm x 150 cm (+/- 5 cm) z przylepcem na dłuższym boku ewentualnie umożliwiającym repozycjonowanie serwety, wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m², odporności na przenikanie cieczy min. 240 cm H₂O i chłonności min. 570%. - 2 szt.
2. Serweta z wycięciem U kształnym na dłuższym boku (63 cm x 7 cm) o wymiarach 240 cm x 150 cm (+/- 5 cm), wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m², o odporności na przenikanie cieczy min. 240 cm H₂O i chłonności min. 570% 1 szt.
3. Serweta z przylepcem ewentualnie umożliwiającym repozycjonowanie serwety o wymiarach 150 cm x 90 cm (+/- 3 cm), wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m², odporności na przenikanie cieczy min. 240 cm H₂O i chłonności min. 570%. - 1 szt.
4. Serweta z przylepcem ewentualnie umożliwiającym repozycjonowanie serwety o wymiarach 240 cm x 180 cm (+/- 3 cm), wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m², odporności na przenikanie cieczy min. 240 cm H₂O i chłonności min. 570%. - 1 szt.
5. Pokrowiec na stół Mayo min. 145 cm x 80 cm, powierzchnia chłonna min. 85 cm x 76 cm wzmocniony, składany teleskopowo do środka - 1 szt.
6. Serwetki chłonne do osuszania rąk z włókniny 40 gramowej 4 warstwy o rozmiarach min. 20 cm x 40 cm - 4 szt.
7. Taśma lepna na włókninie o rozmiarach min. 9 cm x 50 cm (+/- 0,5 cm) - szt. 2
8. Kieszka dwudzielna o wymiarach 30 cm x 30 cm (+/- 2 cm.) - 2 szt.
9. Licznik magnetyczny igieł duży (pudełko do liczenia igieł, magnes gąbka, 20 igieł) - 1 szt.
10. Organizator przewodów o rozmiarach 2 cm (+/- 2 mm) x 25 cm (+/- 1 cm) - 1 szt.
11. Skalpel chirurgiczny bezpieczny nr. 10 - 1 szt.
12. Serwety gazowe z nitką RTG 17 nitkowe 4 warstwowe o wymiarach 30 cm x 30 cm - 2 szt.
13. Jałowy opatrunek na włókninie z wkładem chłonnym z opatrunkiem o wymiarach 8 cm x 15 cm (+/- 2 mm.) - 1 szt.

14. Kieszka do liczenia materiału opatrunkowego pięciokomorowa, foliowa, przezroczysta - 1 szt.
15. Pojemnik plastikowy 250 ml, miska - 2 szt.
16. Narzędzie do mycia pola operacyjnego z zamkiem (korcang) plastikowe - 2 szt.
17. Tupfery gazowe 17 nitkowe 50 cm x 50 cm - 6 szt.
18. Czyścik do narzędzi, gąbka do czyszczenia elektrod - 1 szt.
19. Dren Redona z kontrastem RTG, perforacja na długości CH 8 x 70 cm z trokarem dwustronnie ściętym - 1 szt.
20. Butelka Redona do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych 150 - 200 ml z drenem łączącym - 1 szt.
21. Kompres włókninowy 40 gramowy 4warstwowy z nacięciem "O" o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm - 2 szt.
22. Kompresy gazowe 17 nitkowe 12 warstwowe o wymiarach 10 cm x 10 cm z nitką RTG - 20 szt.
23. Kompresy gazowe 17 nitkowe 12 warstwowe o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm z nitką RTG - 20 szt.
24. Tupfery gazowe 17 nitkowe 9,5 cm x 9,5 cm z nitką RTG - 30 szt.

Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie - torba z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylne marginesy. Na wierzchniej i bocznej stronie opakowania ew. oznaczenie zestawu kolorem w celu szybkiego i łatwego rozpoznania zestawu w strefie magazynowej. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

ODPOWIEDŹ

Tak. Dopuszcza. Parametry zaoferowane mieszczą się w wymogach pakietu po modyfikacji.

PYTANIE

Pakiet 1 poz. 4:

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw do cewnikowania zapakowany był w opakowanie typu twarde blister, które stanowi zarazem pojemnik na płyny i zużyty materiał opatrunkowy?

ODPOWIEDŹ

Dopuszcza, nie wymaga.

PYTANIE

Pakiet 1 poz. 1, 2, 4:

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji oferowanych wyrobów?

ODPOWIEDŹ

Tak, wymaga tylko do wglądu na wezwanie zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet 1 poz. 1:

Czy Zamawiający zgadza się na następującą zmianę parametrów ocenianych

>= 250 cm H₂O – 10 pkt

< 250 cm H₂O – 0 pkt?

ODPOWIEDŹ

Tak, wyraża zgodę.

PYTANIE

Pytania dot. projektu umowy:

Czy nie doszło do omyłki w § 2 ust. 2 w zapisie „Dostawy Przedmiotu umowy będą realizowane w okresie 24 miesięcy”, ponieważ w treści SIWZ oraz ogłoszenia znajduje się informacja o okresie obowiązywania umowy 12 miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający koryguje powyższy zapis. Umowa obowiązuje w okresie 12 miesięcy.

PYTANIE

Pytania dot. projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt b) oraz c) wzoru umowy wyrażenie „5% łącznej wartości brutto umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Należy wskazać, że wysokość kar ustanowiona została na optymalnym poziomie, w związku z czym jakakolwiek zmiana będzie niekorzystna dla zamawiającego. Z uwagi na dysponowanie przez Zamawiającego środkami publicznymi oraz prowadzenie działalności mającej na celu ochronę zdrowia i życia pacjentów zasadne jest pozostawienie kar na dotychczasowym poziomie, co ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy i zapewnienie ochrony zamawiającego.

PYTANIE

Pytania dot. projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wprowadza dodatkowy zapis:

Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający jednokrotnie pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 1, 2, 4

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wymaga próbek sterylnych.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy z serwetą 180 x 180 cm, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H₂O (pozycja 1 zestawu)?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający określił minimum dla parametru odporności na przenikanie cieczy, a proponowana wielkość nie mieści się w określonym przedziale.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy z serwetą 240 x 150 cm, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H₂O (pozycja 2 zestawu)?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający określił minimum dla parametru odporności na przenikanie cieczy, a proponowana wielkość nie mieści się w określonym przedziale.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy z serwetą 150 x 200 cm, wycięcie U 6 x 65 cm, wykonana z trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze 50g/m², wzmocniona w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 110 cm H₂O (pozycja 3 zestawu)?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający określił minimum dla parametru odporności na przenikanie cieczy, a proponowana wielkość nie mieści się w określonym przedziale.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy z serwetą 150 x 100 cm, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H₂O (pozycja 4 zestawu)?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający określił minimum dla parametru odporności na przenikanie cieczy, a proponowana wielkość nie mieści się w określonym przedziale.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy z pokrowcem na stolik Mayo w rozmiarze 140 x 80 cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Określone minimum dł. pokrowca to 145 cm

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy z ręcznikami do osuszania rąk z włókniny celulozowej 56 gramowej?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy z taśmą lepną w rozmiarze 10 x 50 cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający określił tolerancję dla długości i szerokości taśmy lepnej, a proponowana wielkość nie mieści się w określonym przedziale.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy z kieszenią dwudzielną w rozmiarze 30 x 40 cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający określił tolerancję dla długości i szerokości kieszeni, a proponowana wielkość nie mieści się w określonym przedziale.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy z licznikiem magnetycznym igieł na 30 miejsc?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy z organizerem przewodów o rozmiarach 2 x 22 cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający określił tolerancję dla długości i szerokości organizera przewodów, a proponowana wielkość nie mieści się w określonym przedziale.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy z serwetami gazowymi o wymiarach 45 x 45 cm (zamiast 30 x 30 cm)?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga serwet w rozmiarze 30 x 30cm.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy z kieszenią do liczenia materiału opatrunkowego (poz. 14 zestawu) z przednią częścią przezroczystą, tylna część niebieska?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy z drenem (pozycja 19 zestawu) bez trokaru?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści, zamawiający wymaga drenu z trokarem.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy z butelką redona (pozycja 20 zestawu) do niskociśnieniowego drenażu?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga butelki do drenażu wysokociśnieniowego.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy z kompresem włókninowym (pozycja 21 zestawu) w rozmiarze 9 x 10 cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści, zamawiający wymaga kompresu 7,5 x 7,5 cm .

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy z tupferami gazowymi (pozycja 24 zestawu) w rozmiarze 15 x 15 cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści, zamawiający wymaga tupferów 9,5 x 9,5 cm .

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy z etykietą produktową wewnątrz zestawu i oznaczeniem kolorystycznym na etykiecie?

ODPOWIEDŹ

Tak dopuści zestaw z etykietą wewnątrz zestawu, pod warunkiem że jest czytelna bez konieczności otwierania zestawu, wymaga jednak ewentualnego oznaczenia zestawu kolorem na powierzchni bocznej i na frontowej części opakowania. (parametr oceniany).

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw opatrunkowy do centralnego wklucia żylnego z serwetą (pozycja 1 zestawu) z otworem 6 x 8 cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści, zamawiający wymaga serwety z regulowanym otworem 7,5 x 10 cm..

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw opatrunkowy do centralnego wklucia żylnego z serwetami (pozycja 1 i 2 zestawu) o odporności na przenikanie cieczy 120 cm H₂O?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający określił minimum dla parametru odporności na przenikanie cieczy, a proponowana wielkość nie mieści się w określonym przedziale.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw opatrunkowy do centralnego wklucia żylnego z kleszczykami metalowymi lub igłotrzymaczem 15 cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw opatrunkowy do centralnego wklucia żylnego z pojemnikiem plastikowym okrągłym?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw opatrunkowy do centralnego wklucia żylnego w opakowaniu folia-papier ze zgrzewem prostym bez wycięcia na kciuk, 2 naklejki typu TAG?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści 2 naklejki TAG, jednak wymaga wycięcia na kciuk w opakowaniu sterylizacyjnym.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wiązane ochraniacze na buty powyżej kostki wykonane z laminatu PP/PE o gramaturze 63g/m², szwy poliestrowe dodatkowo zakryte taśmą, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane, niesterylne?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę i wydziela pozycję 3 z pakietu nr 1. W Pakiecie nr 1 nie należy wyceniać tej pozycji.

Z wykreślonej pozycji nr 3 z pakietu nr 1 tworzy się pakiet nr 5.

W związku z powyższym zmianie ulega wartość wadium dla pakietu nr 1. Winna ona wynosić:

Pakiet nr 1- 1600,00PLN

Wartość dla nowoutworzonego pakietu nr 5 wynosi:

Pakiet nr 5- 80,00PLN

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z serwetą z laminatu w rozmiarze 50 x 70 cm (w miejsce serwety 50 x 60 cm)?

ODPOWIEDŹ

Tak, pod warunkiem, że będzie to laminat FB.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z serwetą z laminatu w rozmiarze 50 x 60 cm z laminatu PP+PE z otworem o średnicy 7 cm (zamiast 5 cm)?

ODPOWIEDŹ

Tak, pod warunkiem, że będzie to laminat FB oraz otwór będzie posiadał rozcięcie.

PYTANIE

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z serwetą z pojemnikiem okrągłym 120 ml?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści pojemnik 120 ml, jednak nie rozumie co Oferent rozumie pod pojęciem „zestaw z serwetą”

PYTANIE

Pakiet 2, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę cewników w rozmiarze CH14-CH24 o długości 105cm i zakończonych jak na zdjęciu:



?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści długości 105 cm – wymaga długości 150 cm. Dopuści końcówki zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (nie może wnioskować ze zdjęcia bez opisu).

PYTANIE

Pakiet 2, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę cewników z zatyczkami i wkładkami w rozmiarze CH14-CH22 i bez zatyczki CH24-CH28 ?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści, wymaga cewników z zatyczkami.

PYTANIE

Pakiet 2, Pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści dren do tlenu o średnicy wew. 3,9mm i zew. 6,5mm ?


ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zaproponowane parametry są dalece rozbieżne od opisanych przez zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet 2, Pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści zaofierowanie drenu tlenowego o zakończeniu w obu przypadkach - jak na zdjęciu:

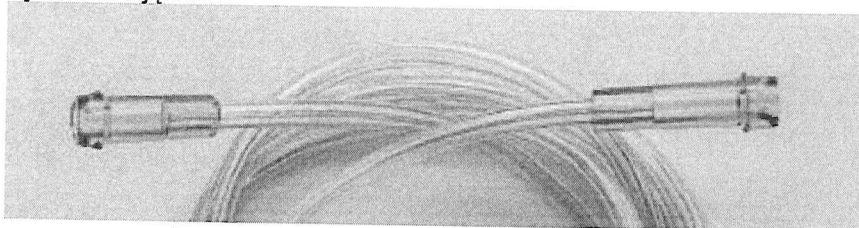

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści w obu przypadkach, tylko w poz. 2.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wymaga próbek sterylnych.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej z serwetą 190 x 230 cm z samoprzylepnymi otworami brzuszny i kroczonej, osłony na kończyny zintegrowana z całością serwety, wykonana z trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze 50g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro 205,6/199,4 kPa, odporność na przenikanie cieczy 41,7 cm H₂O, chłonność wzmocnienia min. 680% (pozycja 1 zestawu)?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Parametry takie jak rozmiar, gramatura i chłonność znacznie odbiegają od wymaganych przez zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej z serwetą 150 x 180 cm, włóknina 28g/m², folia PE 25g/m², włóknina 22g/m², odporność na przenikanie cieczy 180 cm H₂O, odporność na rozrywanie na sucho/mokro 108/95 kPa (pozycja 2 zestawu)?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Odporność na przenikanie cieczy jest 80% mniejsze niż wymagane, a grubość folii o ponad 30 % mniejsza.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej z kieszenią foliową 2 komorową samoprzylepną o wymiarach: lewa kieszeń 15 x 30 cm, prawa kieszeń 25 x 30 cm (pozycja 3 i 4 zestawu)?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, w każdej pozycji po 2 szt.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej z organizatorem przewodów 2 x 22 cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Proponowany rozmiar organizera nie mieści się w przedziale ustalonym przez zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej z taśmą lepnią 10 x 50 cm, wykonana z włókniny spunlace 68g/m²?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Proponowany rozmiar taśmy lepnej nie mieści się w przedziale ustalonym przez zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej z drenem (pozycja 7 zestawu) CH24, łączniki dostosowane do standardowych końcówek do ssania?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga drenu 21CH.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej z końcówką typu Yankauer (pozycja 8 zestawu) CH21, końcówka z kulką, długość 26 cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga drenu 18Ch dł. 25 cm.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej z uchwytem jednorazowym z elektrodą nożową z pochewką, dł. kabla 3,2m, wtyk 3-pinowy (pozycja 9 zestawu)?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wymaga opisanego narzędzia .

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej z workiem do liczenia gazików z przezroczystym przodem, niebieskim tyłem, 5 komór?

ODPOWIEDŹ

Tak, pod warunkiem, że 5 komór będzie podzielone na 10 kieszeni.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej bez pętli silikonowej w zestawie?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zestaw stanowi całość i nie ma możliwości wyłączania poszczególnych pozycji.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej z miską niebieską, nieprzeźroczystą?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej z ostrzem nr 10 lub 11P (pozycja 15 zestawu)?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga skalpela bezpiecznego z wysuwającym ostrzem Nr 11, a nie ostrza 10 lub 11.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej z kleszczykami blokowanymi 23 cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, proponowana długość nie mieści się w opisanym przez zamawiającego przedziale.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej z pojemnikiem do liczenia igieł 30 miejsc?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wymaga licznika 40 stanowiskowego.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej z kompresem gazowym z gazy 17 nitkowej, kompres biały?

ODPOWIEDŹ

Nie, wymaga kompresu zielonego.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej z tupferami (pozycja 20 i 21) 17 nitkowymi?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej z osłoną na stolik Mayo 80 x 140 cm, wzmocnienie 60 x 140 cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wymaga osłony Mayo o dł.145 (+ 5 cm). Dopuszcza powiększony wymiar warstwy chłonnej.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej z ręcznikami chłonnymi o wymiarach 30 x 30 cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej z serwetami z laminatu o chłonności 350%, warstwa folii PE 25g/m²?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, pod warunkiem spełnienia pozostałych opisanych wymagań.

PYTANIE

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzuszno-kroczonej w opakowaniu z etykietą produktową wewnątrz zestawu, oznaczenie kolorystyczne na etykiecie?

ODPOWIEDŹ

Tak dopuści zestaw z etykietą wewnątrz zestawu, pod warunkiem że jest czytelna bez konieczności otwierania zestawu, wymaga jednak ewentualnego oznaczenia zestawu kolorem na powierzchni bocznej i na frontowej części opakowania (parametr oceniany).

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z serweta na głowę pacjenta (pozycja 1 zestawu) wykonaną z laminatu o gramaturze 30g/m² i folii PE 26 g/m²?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Gramatura może być podwyższona o max 10 %, a proponowany parametr przekracza dopuszczalny limit.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z serwetą na stół instrumentariuszki o obszarze chłonnym 65 x 190 cm, wykonaną z laminatu o gramaturze 28 g/m² oraz folii PE 35 g/m²?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Gramatura może być podwyższona o max 10 %, a proponowany parametr przekracza dopuszczalny limit. Pozostałe parametry również znacznie odbiegają od wartości granicznych opisanych przez zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z serwetą operacyjną z przylepnym U o wymiarach 200 x 260 cm, rozmiar U 8,5 x 85 cm, wykonaną z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m², odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej 110 cm H₂O?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wszystkie zaproponowane parametry znacznie odbiegają od wartości dopuszczonych przez zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z serwetą (pozycja 4 zestawu) wykonaną z laminatu o gramaturze 28 g/m² i folii PE 25 g/m², oraz warstwy komfortowej od strony pacjenta, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 180 cm H₂O?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wszystkie zaproponowane parametry znacznie odbiegają od wartości dopuszczonych przez zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z serwetą (pozycja 5 zestawu) o wymiarach 50 x 75 cm, wykonaną z laminatu (włóknina 30g/m² + folia 30g/m²)?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wszystkie zaproponowane parametry odbiegają od wartości dopuszczonych przez zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z serwetą (pozycja 6 zestawu) z max wielkością otworu 7 cm, składającą się z dwóch części przyklejonych o wymiarach 45 x 75 cm, każda wykonana z laminatu (włóknina 30g/m² + folia 30g/m²), odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 120 cm H₂O?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga serwetę z otworem regulowanym do 20 cm, a nie max 7 cm jak zaproponowana powyżej.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z serwetą (pozycja 7 zestawu) o wymiarach 75 x 90 cm, wykonaną z laminatu o gramaturze 28 g/m² i folii PE 25 g/m², oraz warstwy komfortowej od strony pacjenta, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 180 cm H₂O?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wszystkie zaproponowane parametry odbiegają od wartości dopuszczonych przez zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z serwetą (pozycja 8 zestawu) o wymiarach 150 x 100 cm, (włóknina 30g/m² + folia 30g/m²)?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wszystkie zaproponowane parametry odbiegają od wartości dopuszczonych przez zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z serwetą (pozycja 9 zestawu) o wymiarach 150 x 180 cm, wykonaną z laminatu o gramaturze 28 g/m² i folii PE 25 g/m², oraz warstwy komfortowej od strony pacjenta, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 180 cm H₂O?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wszystkie zaproponowane parametry odbiegają od wartości dopuszczonych przez zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z serwetą (pozycja 10 zestawu) o wymiarach warstwy chłonnej 60 x 140 cm, serwetę składaną teleskopowo, gramatura folii 50g/m², gramatura wzmocnienia 30g/m²

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wszystkie zaproponowane parametry odbiegają od wartości dopuszczonych przez zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z osłoną na kończyne (pozycja 11 zestawu), wykonaną z laminatu o gramaturze 28 g/m² oraz folii PE 28 g/m²?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wszystkie zaproponowane parametry odbiegają od wartości dopuszczonych przez zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z serwetą (pozycja 12 zestawu) wykonaną z laminatu o gramaturze 28 g/m² i folii PE 25 g/m², oraz warstwy komfortowej od strony pacjenta, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 180 cm H₂O?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wszystkie zaproponowane parametry odbiegają od wartości dopuszczonych przez zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z taśmą samoprzylepną z włókniny typu spunlance (celulozowo-poliestrowa) o gramaturze 68 g/m², bez warstwy folii?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga taśmy samoprzylepnej z folią.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z organizatorem przewodów - taśma chirurgiczna typu rzep 2cm x 22cm, składający się z dwóch części - haczyka i pętelki. Na jednej części znajduje się taśma lepna umożliwiająca zamocowanie rzepu na serwecie?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Takie rozwiązanie nie gwarantuje wielokrotnego przyklejania i odklejania organizera.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z licznikiem igieł i ostrzy, podwójny magnes, z usuwaczem ostrzy, liczba pól: 30, czerwony, mocny zatrzask zapobiega otwarciu pudełka, specjalne zawiasy umożliwiają rozłączenie dwóch połówek pudełka, na zewnętrznej stronie przylepiec, 11,5cm x 5,5cm x 1,5cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z kieszenią foliową (pozycja 16 i 17 zestawu) w rozmiarze 30 x 40 cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. W każdej pozycji (16 i 17) zamawiający wymaga innego wymiaru kieszeni, a proponowany wymiar nie mieści się w przedziale wielkości opisanym przez zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z pokrowcem na przewody 250 x 16 cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wymiar 18 cm jest wielkością minimalną dla zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji płuca z drenem łączącym do ssaka CH24?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Zamawiający wymaga drenu 21 Ch.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji płuca z bandażem elastycznym zawierającym wiskozę, poliamid i bezlateksowy polimeł, o wymiarach 10 cm x 400 cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów (cienki, lekki, sprężysty, samoprzylegający, oddychający).

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji płuca z kleszczykami 18 cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści, pod warunkiem, że posiadają zatrzask.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji płuca z tacką plastikową 42cm x 34cm x 2,5cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Tacka plastikowa na płyny o wys. 2,5 cm (a nie 5 cm jak opisana) o pojemności 3100 ml. jest bardzo niewygodna w użyciu.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji płuca z kompresem gazowym 17 nitkowym (pozycja 29 zestawu)?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji płuca z kompresem gazowym 12 warstwowym (pozycja 30 zestawu)?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wymaga kompresu grubszego 17-nitkowego.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji płuca z serwetą operacyjną z gazy 45cm x 45cm, 4-warstwowa, 17-nitkowa, z tasiemką i nitką RTG (pozycja 31 zestawu)?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wymaga serwety 30 x 30 cm.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji płuca z opatrunkiem włókninowym z wkładem chłonnym, samoprzylepny 10cm x 30cm? (pozycja 34 zestawu)?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wymaga opatrunku silikonowego, pięciowarstwowego, wodoodpornego, samoprzylepnego etc.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z opatrunkiem włókninowym z wkładem chłonnym, samoprzylepny 8cm x 15cm? (pozycja 35 zestawu)?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wymaga opatrunku silikonowego, pięciowarstwowego, wodoodpornego, samoprzylepnego etc.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji płata ze strzykawką (pozycja 37 zestawu) z tłokiem wykonanym z polipropylenu?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wymaga strzykawki niskooporowej, a to stanowi o wyposażeniu jej w gumowy tłok.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji płata ze strzykawką (pozycja 38 zestawu) 3-częściową?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z kompresem 10 x 10 cm z wycięciem „Y” (pozycja 41 zestawu)?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wymaga kompresu z nacięciem „O”, a nie „Y”.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z tupferem 15 x 15 cm (zamiast 10 x 10 cm)?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wielkość proponowanego tupfera jest 50% większa niż wymagana przez zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z organizatorem przewodów 2 x 22 cm?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści, gdyż wymaga organizera 2,5 x 30 cm.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z ręcznikami do rąk o wymiarach min. 30 x 30 cm?

ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z osłoną na stół instrumentalny z warstwą chłonną o wymiarach 65 x 260 cm, laminat dwuwarstwowy 28 g/m² oraz folia PE 35 g/m²?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Wszystkie zaproponowane parametry odbiegają od wartości dopuszczonych przez zamawiającego.

PYTANIE

Pakiet nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji płata z zawartością zestawu oraz oznaczeniem kolorystycznym na etykiecie wewnętrznej?

ODPOWIEDŹ

Tak dopuści zestaw z etykietą wewnątrz zestawu, pod warunkiem że jest czytelna bez konieczności otwierania zestawu, wymaga jednak ewentualnego oznaczenia zestawu kolorem na powierzchni bocznej i na frontowej części opakowania (parametr oceniany).

PYTANIE

Pakiet nr 3, poz. 4 (800 szt.)

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji chirurgicznej brzusznej o poniższym składzie i parametrach:

1. Serweta operacyjna dolna z taśmą lepną, wzmocniona o wymiarach 180cm x 180cm, posiada dodatkową warstwę wysokochłoną, gramatura min. 50g/m² w strefie krytycznej, rozmiar min 20x55cm, serweta wykonana z włókniny 30 g/m², folii PE - 30 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 197 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro 180/172 kPa – 1 SZT
2. Serweta operacyjna górna, wzmocniona z taśmą lepną o wymiarach 240x150 cm (+/- 3 cm), posiada dodatkową warstwę wysokochłoną, gramatura min 50g/m² w strefie krytycznej, rozmiar min. 20x55cm, serweta wykonana z włókniny 30 g/m², folii PE - 30 g/m², odporność na przenikanie cieczy powyżej 197 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro 180/172 kPa – 1 SZT
3. Serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 100cm x 150cm, o gramaturze min. 23 g/m², folii PE - 25 g/m², warstwy polipropylenowej 22 g/m², odporność na przenikanie cieczy 180 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 91/74 kPa – 2 SZT
4. Serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 150cm x 180cm, wykonana z włókniny o gramaturze 28 g/m², folii PE - 25 g/m², warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta polipropylen 22 g/m², odporność na przenikanie cieczy 180 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 91/74 kPa– 2 SZT
5. Osłona na stół Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm (+ 5 cm) z mocnej folii o grubości 50 mikronów , z dodatkową zewnętrzną warstwą chłoną w górnej części (pod narzędzia) o wym. Min. 65x 85cm o gramaturze 30 g/m² oraz folii PE 50 mikronów-2 SZT.
6. Ręcznik chłonny o wymiarach min. 18x25cm – 4 SZT
7. Licznik igieł i ostrzy, podwójny magnes, z usuwaczem ostrzy, liczba pól: 30, czerwony, mocny zatrzask zapobiega otwarciu pudełka, 11,5cm x 5,5cm x 1,5cm – 1 SZT
8. Taśma lepna wykonana z włókniny typu Spunlace o gramaturze min.40g/m² o wymiarach 10cmx50cm – 2 SZT
9. Kieszka foliowa 2-komorowa samoprzylepna o wymiarach 40cm x 30cm – 3 SZT.
10. Organizator przewodów przyklejany, regulowany na rzep o wymiarach 2cm x 22cm - 3 SZT
11. Dren łączący do ssaka CH24 o długości 3m, ze stożkowatymi końcówkami – 1 SZT
12. Końcówka typu Yankauer CH21 z bulwiastą końcówką o długości 26cm i 4 otworami – 1 SZT
13. Skalpel chirurgiczny bezpieczny z wysuwającym ostrzem nr 11P – 1 SZT
14. Skalpel chirurgiczny bezpieczny z wysuwającym ostrzem nr 20 – 1 SZT
15. Uchwyt jednorazowy z elektrodą nożową z pochewką, dł. kabla 3,2m, wtyk 3-pinowy- 1 SZT
16. Cewnik do odsysania dróg żółciowych PVC 12Ch z dwoma otworami o długości 40cm, prosty – 1 SZT

17. Kompres gazowy o wymiarach 10x 10cm, 8 warstwowy, 17 nitkowy, z nitką RTG – 40 SZT
18. Kompres włókninowy 10 x 20cm, 30g, 4 warstwowy, biały - 12 SZT
19. Kompres gazowy laparotomijny z tasiemką o wymiarach 45x45cm, gaza 17-nitkowa, 4 warstwowy, znacznik RTG, biały – 5 SZT
20. Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 15 x16cm (+/- 1 cm), 20-nitkowy, z nitką RTG, biały - 10 SZT
21. Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 10 x 10cm (+/- 1 cm), 20-nitkowy, z nitką RTG, biały - 20 SZT
22. Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 30 x 30 cm (+/- 1 cm), 20-nitkowy, z nitką RTG, biały - 20 SZT
23. Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny wymiarach 10 x 30 cm (+/- 0,5 cm) – 1 SZT
24. Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny o wymiarach 10 x 20 cm (+/- 0,5 cm) – 1 SZT
25. Kieszeń do liczenia materiału opatrunkowego, przezroczysty przód, niebieski tył 5 x 2 kieszonki– 2 SZT
26. Miska z polipropylenu z podziałką, niebieska, 250ml – 2 SZT
27. Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 23cm (+/- 1 cm) – 2 SZT
28. Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 50cm x 50cm (+/- 2 cm), 20-nitkowy, biały - 6 SZT
29. Serweta wzmocniona na stolik 150 x190cm (+/- 3 cm), służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 28 g/m², folia PE 35 mikronów, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, chłonność wzmocnienia w strefie krytycznej 350%, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 108/95 kPa, obszar chłonny o wymiarach 65cm x 190cm (+ 5 cm) – 1 SZT.
30. Torba papierowa – 1SZT

Zawartość zestawu i oznaczenie kolorystyczne opisane na etykiecie wewnętrznej.

ODPOWIEDŹ

Nie, nie dopuści. Większość zaproponowanych przez oferenta parametrów jest rozbieżna od wymaganych przez zamawiającego (zarówno włóknin jak i rozmiarów i rodzaju sprzętu , rodzaju opatrunków, wielkości i grubości opatrunków), dlatego zamawiający nie może wyrazić zgody na zaproponowanie zestawu w wyżej opisanej przez oferenta formie.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 14.12.2020r. do godz. 08.00

Otwarcie ofert w dniu 14.12.2020 r o godz. 12.00

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomicznych

mgr inż. Magdalena Kraszewska